

وائزليس تيكنولوجى کے ذریعے Bluetooth® ایپ سے خود کار طور پر وقتی مطابقت پیدا کر لیتا ہے۔ جزو ابتدی اور وقتی مطابقت کے لیے حالہ جاتی مراحل پشت کی طرف دیے گئے ہیں۔

تبادلی بیسٹریان شامل ہیں!
آپ کے میتر کے سفری خول میں دو تبدالی CR2032 ڈیسوالت کی لیٹھیم بیسٹریان شامل ہیں۔ بیسٹری بدلتے کی بدایت پشت کی طرف دیکھیں۔

سواخ کرنے کا نظام:

- (1) کونک پینٹل
- (2) گہرائی ظاہر کرنے والی کھڑکی
- (3) گہرائی
- (4) ریزیز بین
- (5) سوئی کو باہر نکالنے والا پروزہ
- (6) سواخ کرنے والے آئے کا ڈھانچہ
- (7) سوئی کا ہولڈر
- (8) سوئی گیر توپی
- (9) متبدل مقام کی جانچ کی توپی (شاف)
- (10) سوئی
- (11) سوئی کا ڈھنکن



جانچ پشی:

- (1) رابطہ بار اس سرے کو جانچ پشی پورٹ میں داخل کریں
- (2) ڈیزیل فل کھڑکی: جب کافی نمونہ ڈالا جاتا ہے تو پوری طرح بہر جاتی ہے
- (3) نمونے کا ایپیا: خون یا کنٹرول محاول یہاں لکایا جاتا ہے



بلڈ گلوکوز میٹر:

- (1) نسلہ اپریا
- (2) جانچ پشی پورٹ
- (3) میٹرین: میٹر کو چالو کرنے کے لیے دبائیں اور گلوکوز کی پچھلی جانچ کے نتائج دیکھیں۔



سیسٹم کے بارے میں:

آگامیٹرکس ویوسنس جاز وائزليس بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم میٹرین شیاون میں بہتے مکمل خون میں گلوکوز کی سطحوں کی جانچ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مکمل بدایات کے اپنا بدایت نامہ صارفین آگامیٹرکس ویوسنس جاز وائزليس دیکھیں۔

انتباہ: آگامیٹرکس سواخ کرنے والے آئے صرف ایک بھی شخص کو خود اپنی جانچ کے لیے نمونہ خون لینے کی غرض سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے کوئی سوئی یا سواخ کرنے والے آئے استعمال نہ کریں جو کسی دوسرے شخص نے استعمال کیا ہو۔

سواخ کرنے والے نظام کی تیاری



2 جانچ کے مقام پر سواخ کریں:

سواخ کرنے کا آئے تیار کرنے کا طریقہ جانچ کے لیے دابنے طرف دی گئی بدایات دیکھیں۔ جس مقام پر سواخ کرنا ہے سواخ کرنے والے آئے کا اس کے مقابل دبائیں اور ریزیز بنن دبائیں۔



4 جانچ پشی کو نمونہ خون کے پاس لائیں:

میٹر پر، جانچ پشی پر خون کا نمونہ لگائیں، متھرک دکھاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خون لگائے جانے کے لیے تیار ہے۔

جانچ پشی کو نمونے کے مقام سے خون کو جانچ پشی میں کلینچ لیتی ہے۔



6 جانچ کے نتیجے اور آخری مراحل پر نظر ڈالیں:

جانچ کے متھرک کا نتیجہ میٹر سپلے پر ظاہر ہوگا۔ جانچ کا نتیجہ میٹر کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔

استعمال شدہ جانچ پشی کو میٹر سے الگ کر دیں۔ میٹر خود کار طور پر بند ہو جاتے ہیں۔

سوئی گیر توپی کو الگ کر دیں اور سوئی کا ڈھنکن دوبارہ لگا دیں۔ استعمال شدہ سوئی بنا دیں۔

استعمال شدہ جانچ پشی اور سوئی کو مناسب طور پر ضائع کر دیں۔ اسے ضائع کرنے کے لیے اپنے نگہداشت صحت کے ماہر کی بدایات پر عمل کریں۔

5.6 mmol/L



1 بلڈ گلوکوز کی جانچ کے مراحل (مکمل بدایات کے لیے اپنا بدایت نامہ صارفین برائے آگامیٹرکس ویوسنس جاز وائزليس دیکھیں)

1 میٹر میں داخل کریں:

رابطہ باروں کو اپر کی طرف رکھتے ہوئے جانچ پشی کو جانچ پشی پورٹ میں داخل کریں۔ میٹر خود کار طور پر فعال ہو جاتے گا۔



3 خون کا ایک قطرہ حاصل کریں:

ایسی انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف نچوتے ہوئے دبائیں، یہاں تک کہ خون کا ایک مختصر سا قطرہ آجائے۔



5 جب جانچ پشی کی ویبیل فل کھڑکی پری طرح سرخ ہو جائے اور میٹر بیپ دے تو خون کے نمونے سے الگ کریں:

میٹر کے اسکرین پر نمونہ لگائے جانے کی علامت ظاہر ہوئے اور آپ کو نمونہ خون سے جانچ پشی کے بنانی ہے، میٹر اس کی بیپ کرے گا۔



پوی ویبیل فل کھڑکی۔

جانچ کے نتیجے کے حساب لگائے کے دوران میٹر کے ڈسپلے پر جانچ کے نتیجے نظر آئیں گے۔

فوری اسٹارٹ ہدایت نامہ

آگامیٹرکس ویوسنس جاز (AgaMatrix WaveSense) اور ایپلیکیشن جاز و ایپلیکیشن میٹر کے ساتھ CR2032 یا DL2032 بیسیزیاں استعمال کریں۔



جوڑا بندی اور وقتی مطابقت سے متعلق بدایات

آگامیٹرکس ڈائی بیسیز مینیجر ایپ کی طرف سے iOS اور Android™ آلات پر کام کرتا ہے۔ تجدید شدہ فہرست کے لئے www.agamatrix.co.uk دیکھیں۔

ایپ کے ساتھ اپنے میٹر کی جوڑا بندی اور وقتی مطابقت انجام دینا

گلوکوز کے نتائج کی راست اپنے iOS یا اینڈرائڈ آئی سے براہ راست زمانی مطابقت کے لئے آگامیٹرکس ویوسنس جاز و ایپلیکیشن میٹر کی آگامیٹرکس ڈائی بیسیز مینیجر ایپ (ایپ) کے ساتھ استعمال کریں۔

جانچ کرنے سے پہلے اپنے میٹر کا وقت اور تاریخ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے میٹر کی زمانی مطابقت آگامیٹرکس ڈائی بیسیز مینیجر ایپ (ایپ) سے کافی چاہیے، مقرہ تاریخ اور وقت کے بغیر جانچ کے نتائج وقت اور تاریخ کی جگہ "—" اور "—" کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔

1 ایپ کو ڈائون لوڈ کریں اور کھولیں:



آگامیٹرکس ڈائی بیسیز مینیجر ایپ (ایپ) App Store™ (ایپل آلات کے لیے) یا Google Play™ (اینڈرائڈ آلات کے لیے) پر ڈائون لوڈ کریں۔

اپنے معاونتی آئی پر ایپ کے آئکن پر تپتھپائیں۔



2 میتو آئکن پر جائیں:

تین سطروں سے بنے آئکن پر تپتھپائیں۔

3 نئے میٹر کا اضافہ کریں:

"میٹر" پر تپتھپائیں۔ "نئے میٹر کا اضافہ کریں" پر تپتھپائیں۔

اپنے میٹر پر میٹر بنن کو دبا کر رکھیں۔

ایپ میں ظاہر ہونے پر اپنے میٹر کا انتخاب کریں۔

رمزی کلید کی مثال:

* 354270

4 رمزی کلید (یاس کی) داخل کریں:

6-بندسہ والا رمزی کلید میٹر پر ظاہر ہوگا۔

ایپ میں رمزی کلید نمبر کو داخل کریں۔

صحیح کے نشان کی مثال:




5 جوڑا بندی کی تصدیق کامیاب ہے:

میٹر اور ایپ دونوں یہ اشارہ دین گے کہ جوڑا بندی کامیاب تھی۔ میٹر میں صحیح کا نشان آئے گا اور ایپ پر ایک پیغام ظاہر ہوگا۔

6 معلومات کی وقتی مطابقت:

آپ کے میٹر کی آئی کے ساتھ جوڑا بندی کے بعد آپ کے جوڑا بندی کے قریبی رابطے میں پر آئنے پر اس کی "وقتی مطابقت" ہوگی یا معلومات کی منتقلی ہوگی۔

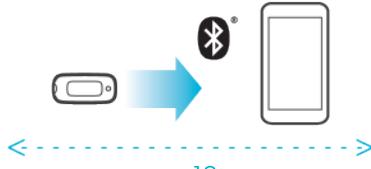

10 میٹر

وضاحت: معلومات کی جوڑا بندی اور منتقلی کے لیے میٹر اور ایپ کو ایک دوسرے سے 10 میٹر کی دوری پر بونا چاہیے۔

بیسیزی تبدیل کرنے سے متعلق بدایات

ضروری: آگامیٹرکس ویوسنس جاز و ایپلیکیشن میٹر کے ساتھ صرف CR2032 یا DL2032 بیسیزیاں استعمال کریں۔

بیسیزی ڈسپلے پیغامات

کم بیسیزی کا پیغام: (لے طاہر ہوتا ہے) کم بیسیزی کا پیغام دیکھنے پر بھی آپ کوی جانچ انجام دے سکتے ہیں لیکن بیسیزیاں جلد از جلد بدل دی جانی چاہیں۔ صرف CR2032 یا DL2032 بیسیزیاں بھی استعمال کریں۔

بیسیزی ناکارہ ہونے کا پیغام: آپ کے میٹر کی بیسیزیوں میں آپ کے میٹر کو چالو کرنے اور جانچ انجام دینے کی کافی طاقت نہیں ہے۔ بیسیزیوں کو لازماً تبدیل کیا جانا چاہیے۔

بیسیزیوں کی تبدیلی: (مزید تفصیلات کے لیے اپنا آکا میٹرکس ویوسنس جاز و ایپلیکیشن کا بدایت نامہ صارفین دیکھیں)۔

ضروری: جب بیسیزیاں تبدیل کی جائیں تو آپ کے میٹر سے تاریخ اور وقت مت جائیں گے یہ یقینی پنانے کے لیے کہ آپ کو جانچوں کی رینڈر میں تاریخ اور وقت شامل ہیں، آپ کو اپنے میٹر کی وقتی مطابقت معاونتی آئی سے کرنی جائیں اپنے میٹر کی وقتی مطابقت انجام دینے کے لیے دائیں جانب دی گئی بدایات دیکھیں۔

وضاحت: بیسیزیاں پنانے سے گلوکوز کے جمع شدہ نتائج کے ریکارڈ پر کوئی انحرافیں پڑتا۔


1 بیسیزی کا دروازہ کھولیں:

یہ یقینی پنانیں کہ میٹر بند ہے، بیسیزی کے دروازے کو دیکھتے ہوئے میٹر کو کھوائیں۔ بیسیزی کے دروازے کو میٹر سے کھلسا کر بنا دین۔



2 استعمال شدہ بیسیزیوں کو نکال دیں:

کسی غیر دھاتی اوزار سے استعمال شدہ بیسیزیاں باہر نکال دین۔



استعمال شدہ بیسیزیاں



نئی بیسیزیاں

3 نئی بیسیزیاں لگائیں:

آپ کے میٹر کے سفری خول میں بدلي جانے والی دو بیسیزیاں شامل ہیں۔ بدلي جانے والی بیسیزیوں کی جگہ دیکھ لیں۔

اپنے سامنے کی طرف جمع (+) کی علامت والی نئی بیسیزیاں لگائیں۔



نئی بیسیزیاں

4 بیسیزی کا دروازہ بند کریں:

بیسیزی کے دروازے کو میٹر کی طرف کھلسا کریں۔ یہ یقینی پنانیں کہ میٹر استعمال کرنے سے پہلے بیسیزی کا دروازہ پوری طرح بند ہے۔



براہ کم استعمال شدہ بیسیزیوں کو اپنے مقامی ماحولیاتی ضابطوں کے مطابق تلف کریں۔

CE 0123 AgaMatrix, Inc., 7C Raymond Ave Salem, NH 03079 USA EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany

استعمال لائسنس کے تحت ہے دیکھنے مارک اور تجارتی نامان کے متعلقہ مالکان کے پیغام: SIG, Inc. کی ملکیت ہے اور AgaMatrix, Inc. میں ان علامات کا کوئی Apple Inc., Apple Inc., App Store, Apple Inc., Google Inc., Google Play اور جویا ایس اور دیگر مالک میں رجسٹری ہے۔ آنڈرائڈ مارک ایپلیکیشن اور تجارتی نامان کا خدمت کا نشان ہے۔ Google Inc. کا تریکھ مارک ہے۔ Google Play کا تریکھ مارک ہے۔